




iHealth[®] Wave

Motivati. Muoviti. Rileva

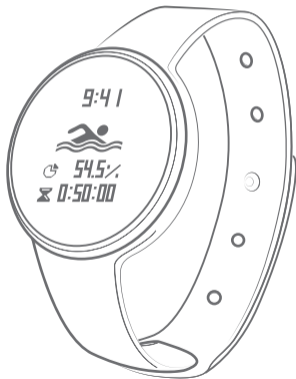

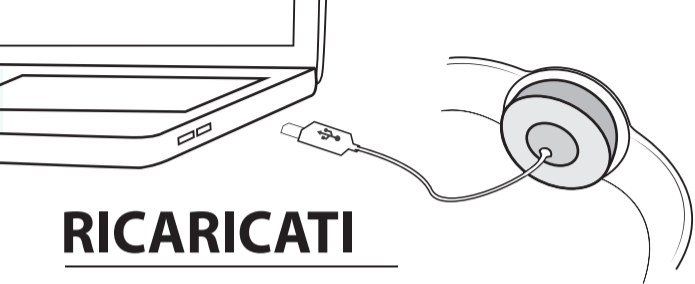

RICARICATI

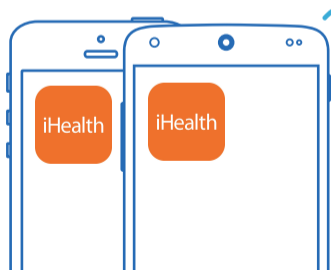


Il tuo dispositivo mobile è compatibile?
Verifica su www.ihealthlabs.com/support!

SCARICA L'APP

Cerca e Scarica "iHealth Myvitals" da App Store o Google Play

1 Scorri verso l'alto il Centro di controllo e abilita il *Bluetooth*




iOS

Scorri verso il basso il Centro di controllo e abilita il *Bluetooth*




ANDROID

2 Apri app e crei un nuovo account

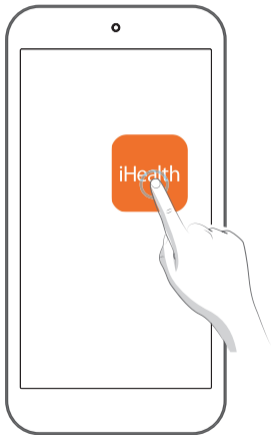

3 Selezioni "Rilevatori attività"

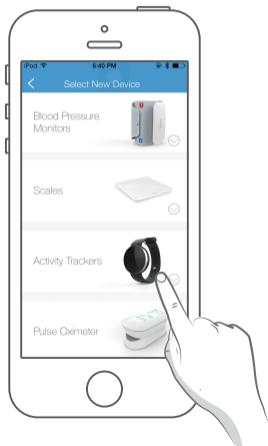

4 Selezioni "Wave (AM4)"





5 Selezioni "Successivo"




6 Collegamento con il dispositivo



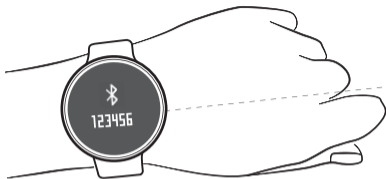


- 7** Inserisci le ultime 2 delle 6 cifre mostrate sul tracker
Se non vedi le 6 cifre, riaccendilo nuovamente oppure fai doppio clic sul pulsante Home (iOS) oppure vai sul menu app (Android) e tocca l'app per chiuderla completamente.
Ripeti i passaggi partendo dal passaggio 2.

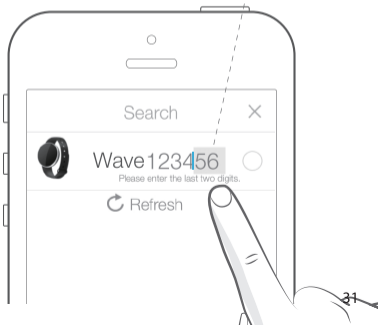

8

Abbinamento eseguito con successo
Clicca su "SYNC" per sincronizzare i
dati per l'applicazione e il cloud

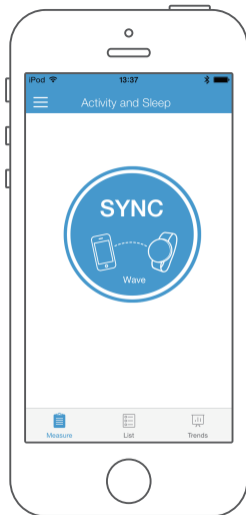

MODALITA' ATTIVITA'

In "Configurazione del dispositivo" è possibile impostare un promemoria per rimanere attivi quando Wave è collegato.

Obiettivo/Progresso



Solleva il polso oppure
sgancialo dalla vita
&
Tocca per navigare

Ora/Data



Numero di passi



Calorie bruciate



Distanza percorsa



RIEPILOGO ALLENAMENTO



Uno speciale riepilogo dell'allenamento verrà generato dopo una camminata o una corsa continua di più di 10 minuti


MODALITÀ SONNO



Rileva automaticamente la qualità del sonno. In "Configurazione del dispositivo" è possibile impostare vibrazione sveglia allarme quando Wave è collegato.

MODALITÀ NUOTO

Utilizzi Wave per monitorare i tuoi nuoto. Identifica inoltre vari stili di nuoto inclusi stile libero, rana, dorso e farfalla.

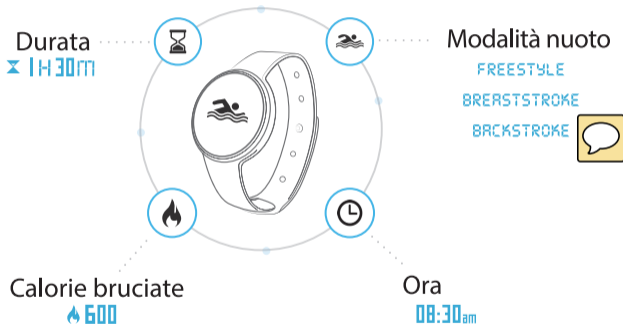

- La modalità nuoto può essere attivata e disattivata nelle in "Configurazione del dispositivo" quando Wave è collegato.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PREVISTE DALLE NORME FCC

Il presente dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il suo funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) Il presente dispositivo non deve causare interferenze dannose, e
- (2) il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Cambiamenti e modifiche non espressamente approvate da iHealth Lab Inc. renderanno nulla l'autorità dell'utente a mettere in funzione il prodotto.

Nota: Il presente prodotto è stato testato e trovato essere conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono ideate per fornire una protezione ragionevole contro l'interferenza dannosa in un'installazione residenziale. Il presente prodotto, genera, usa e può irradiare energia in radio frequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, potrebbe causare interferenza dannosa alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che l'interferenza non si verificherà in una particolare installazione. In caso il presente prodotto cause interferenza dannosa alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato e tentare di correggere l'interferenza mediante una o più delle seguenti misure:

- Orientare o posizionare nuovamente l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa di un circuito differente da quello a cui il ricevitore è collegato.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV competente per assistenza.

Il dispositivo è conforme alla licenza Industry Canada (esente da standard RSS). Il funzionamento è conforme alle due seguenti condizioni:

- (1) il dispositivo potrebbe non causare interferenze, e
- (2) il dispositivo deve accettare le eventuali interferenze, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo

AVVERTENZA

RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA
CON UNA DI TIPO DI DIVERSO.

SMALTIRE LE BATTERIE USATE CONFORMEMENTE ALLE ISTRUZIONI.

Con la presente [iHealth Lab Inc.] dichiara che questo [AM4 WAVE] è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/EC. La Direttiva 1999/5/EC, dichiarazione di conformità e certificazioni di iHealth e i documenti normativi possono essere scaricati usando il seguente link <https://www.ihealthlabs.eu/support/certifications>

Temperatura di esercizio: 0~+40°C

Contatti e numero di assistenza:

Prodotto per iHealth Lab Inc.

iHealth Lab Inc.

719N. Shoreline Blvd., Mountain View, CA 94043, USA

Tel:+1-855-816-7705 www.ihealthlabs.com



Prodotto per iHealth Lab Europe.

3 rue Tronchet, 75008, Paris, France

www.ihealthlabs.eu support@ihealthlabs.eu



ANDON HEALTH CO., LTD.

No. 3 Jinping Street, YaAn Road, Nankai District, Tianjin 300190, China.

Tel: 86-22-60526161

Per maggiori informazioni, visita
www.ihealthlabs.com

iHealth[®] Wave